K Pacific Supply 2023.10.30 パシフィックサプライ行 FAX 072-875-8040

ハートリーフ ビープロン ご発注書　　年　月　日

お客様名（カタカナ表記）　　様分

貴社名	ご担当者名	TEL
ご住所		FAX

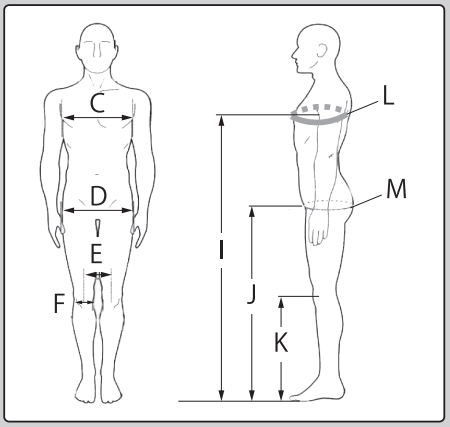

C	胸部幅	mm
D	大転子間幅	mm
E	膝間距離	mm
F	膝幅	mm
I★	腋窩高	mm
J	大転子高	mm
K	膝蓋骨中央高	mm
L	胸囲	mm
M	臀囲	mm

★腋窩高実寸値を必ず記入してください。（支柱寸法の目安：腋窩高から約-11cmがフットプレートから支柱Topの高さです）

＊＊＊参考寸法＊＊＊
①ベースフレーム　※フレーム寸法は最小値です
設計時の腋窩高（Ｉ）を基準に算出
・590未満の場合→Ｓフレーム　（550＊780）
・790未満の場合→Ｍフレーム　（560＊830）
・990未満の場合→Ｌフレーム　（610＊880）
②テーブル寸法(710*550)
③支柱最大寸法
S：500mm　M：700mm　L：900mm

＊＊＊干渉確認＊＊＊
①スライドプレートとボディサポート
【Ｉ】腋窩高と【Ｊ】大転子高の差、220未満干渉
【Ｉ】（　　）－【Ｊ】（　　）＝［　　］
②ボディサポートとニーサポート
【Ｊ】大転子高と【Ｋ】膝蓋骨中央高の差、120未満干渉
【Ｊ】（　　）－【Ｋ】（　　）＝［　　］

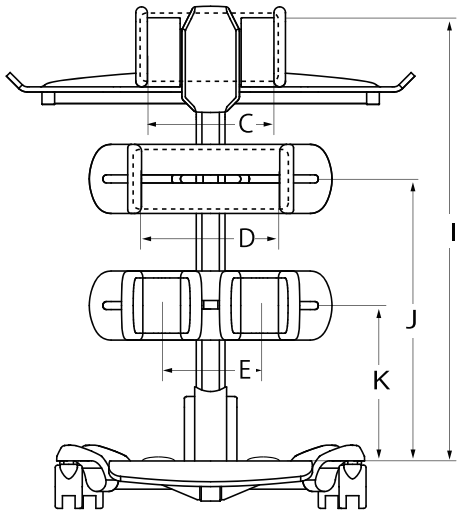

※成長対応のため、腋窩高とフレームサイズが異なる設定を希望する場合は下記項目に☑（チェック）してください。
□ 成長対応のためフレームサイズを大きくする

①本体カラーサイズ選択

品　番	カラー	サイズ	□チェック
69231001	イエロー	S	□
69231002		M	□
69231003		L	□
69231004	ブルー	S	□
69231005		M	□
69231006		L	□
69231007	ピンク	S	□
69231008		M	□
69231009		L	□

土日・祝日を除く営業日　注文受付（12:00締切）FAX　第1日目 製作　第12日目 発送

ビープロン（組立て式）
＊梱包状態によりパッドの高さを再調整していただく場合があります。

②チェストパッド形状をＡ→Ｄから選択し記号を□に記入 →→→ □

③チェストパッドの高さ（t）を設定（０→60　ピッチ10）→→→→ □

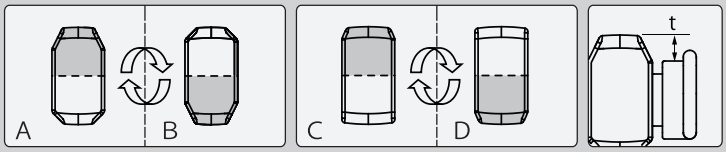

④チェストサポートのサイズと幅（W1 or W2）を選択→サイズ □ W □

⑤チェストサポートの芯材を選択（ＡorＢ）し□に記入 →→→→→ □



A：軟芯

B：硬芯

サイズ	W 1	W 2
S	170	195
M	220	245
L	270	295

単位（mm）

⑥パッド選択（ＳorＭorＬ）→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ □

サイズ	
S	80
M	100
L	120

単位（mm）



サイズ Dmax	
S	260
L	320

単位（mm）

※Dmin 160（S・L 共通）

⑦ボディサポート選択（ＳorＬ）→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→ □

⑧ニーパッドのサイズを選択し（Ｓ or Ｍ or Ｌ）□に記入→→→→→ □



サイズ　F	
S	80
M	100
L	120

単位（mm）



サイズ　Emax	
S	300
L	350

単位（mm）

⑨ニーサポートのサイズ選択（膝間距離Ｅの最大値が異なる）→→ □

弊社記入欄	お得意先様CD	受注No.	